



การประเมินคุณลักษณะของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ในการวัดรังสีแบบไม่มีตัวกรองปรับเรียบ

Evaluation of Dosimetric Characteristics of Electronic Portal Imaging Device (EPID) for Flattening Filter Free (FFF) Beams

อัฐพงศ์ จันทน์โทน, วท.ม.¹, **แสงอุทิศ ทองสวัสดิ์**, วท.ม.², นิพนธ์ สายโย, วท.ม.², นันทวัฒน์ อุ๊ดดี, วศ.ด.^{1*}
Thadpong Chanton, M.Sc.¹, Sangutid Thongsawad, M.Sc.², Nipon Saiyo, M.Sc.², Nuntawat Udee, D.Eng.^{1*}

¹ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ประเทศไทย

²งานรังสีรักษา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย

¹Department of Radiological Technology, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, Mueang, Phitsanulok 65000, Thailand.

²Radiation Oncology Unit, Chulabhorn Hospital, HRH Princess Chulabhorn College of Medical Science, Chulabhorn Royal Academy, Laksi, Bangkok 10210, Thailand.

*E-mail: nuntawatu@nu.ac.th

Songkla Med J 2017;35(4):361-371

บทคัดย่อ:

วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินคุณสมบัติของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ต่อการวัดปริมาณรังสีด้วยการฉายรังสีแบบไม่มีตัวกรองปรับเรียบของรังสีโฟตอนพลังงาน 6 และ 10 เมกะโวลต์

วัสดุและวิธีการ: การประเมินคุณสมบัติของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการฉายรังสีแบบไม่มีตัวกรองปรับเรียบในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย การทดสอบการตอบสนองต่อระยะทาง ภาวะอิมิตัวของการวัดสัญญาณ ความสัมพันธ์เชิงเส้นของค่าปริมาณรังสี และการตอบสนองต่อพื้นที่ลำรังสีขนาดต่างๆ

ผลการศึกษา: พบว่าระยะ 150 และ 180 เซนติเมตร ตามที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำเป็นระยะที่อุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์เหมาะสมสำหรับวัดรังสีพลังงาน 6 และ 10 เมกะโวลต์ โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสัญญาณการวัดในทุกอัตราการใช้ปริมาณรังสีเท่ากับ

รับต้นฉบับวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 รับลงตีพิมพ์วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

± 1.35 และ ± 1.64 แคลลิเบชันยูนิท ตามลำดับ ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นของค่าปริมาณรังสีพบว่าการตอบสนองต่อการวัดรังสีของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะเชิงเส้นตรงทั้งสองระดับพลังงานและผลการทดสอบการตอบสนองของรังสีกับขนาดพื้นที่ลำรังสีพบว่ารังสีแบบมีตัวกรองปรับเรียบมีการตอบสนองต่างกับรังสีแบบไม่มีตัวกรองปรับเรียบ โดยมีค่าความแตกต่างสูงสุด คือ ร้อยละ 5.50 และ 6.78 ที่ระดับพลังงาน 6 และ 10 เมกะโวลต์

สรุป: อุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการวัดปริมาณรังสีแบบไม่มีตัวกรองปรับเรียบ และการเพิ่มระยะทางที่เหมาะสมช่วยลดการอิ่มตัวของภาพการนับวัดได้

คำสำคัญ: การฉายรังสีแบบไม่มีตัวกรองปรับเรียบ, อัตราปริมาณรังสีต่อหน่วยเวลา, อุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์

Abstract:

Objective: To evaluate the dosimetric characteristics of electronics portal imaging device (EPID) for 6 and 10 megavoltage (MV) of flattening filter-free (FFF) beams.

Material and Method: The EPID characteristics for FFF beams have been evaluated as follows; saturation with source-detector-distance (SDD), saturation with dose rate, dose linearity response with monitor unit (MU), and the scattered radiation with field size.

Results: The saturation of signal was not occurred at 150 cm and 180 cm SDD for 6 and 10 MV of FFF beams, respectively. When the signals were measured with optimal SSD according to vendor suggestion (150 cm and 180 cm), the standard deviation for all dose rate were ± 1.35 and ± 1.64 CU for 6 and 10 MV of FFF beams, respectively. The dose linearity response showed that EPID has a good linearity response between signals and MU for the both of 6 and 10 MV of FFF beams. The results of scattered radiation with field size were found that FFF beams have different response from flattening filter (FF) beams with the highest differences of 5.50% and 6.78% for 6 and 10 MV of FFF beams, respectively.

Conclusion: EPID has a good characteristic for FFF beams, and an extended SSD can be used to reduce the saturated signal effects in FFF beams.

Keywords: dose rate, electronic portal imaging device, flattening filter-free beams

บทนำ

อุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ (electronic portal imaging device; EPID) เป็นอุปกรณ์สร้างภาพทางรังสีของเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กทรอนิกส์ (linear accelerator; LINAC) ทำหน้าที่ตรวจสอบตำแหน่งการฉายรังสีเพื่อให้สามารถจัดตำแหน่งของผู้ป่วยให้ถูกต้องก่อนฉายรังสีจริงเพื่อป้องกันความผิดพลาดของการฉายรังสีไม่ตรงเป้าหมาย และช่วยทำให้ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับมีความถูกต้องมากขึ้น คุณสมบัติที่สำคัญของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยความละเอียดในการวัดสัญญาณสูง (spatial resolution) ความสามารถ

ในการอ่านค่าได้ทันที (fast read out) และการวัดสัญญาณมีลักษณะเชิงเส้นตรง (linear response) จึงมีการนำอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการวัดรังสีในกระบวนการประกันคุณภาพก่อนการรักษามากขึ้น ปัจจุบันอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกพัฒนาให้สามารถวัดค่าปริมาณรังสีที่ปลดปล่อยออกมาจากเครื่องเร่งอนุภาคได้ ทำให้มีการนำอุปกรณ์ดังกล่าวมาใช้ในการประกันคุณภาพก่อนการรักษามากขึ้นเพื่อให้การรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเฉพาะการฉายรังสีด้วยเทคนิคขั้นสูง (advanced radiation therapy techniques)^{1,2} อย่างไรก็ตามอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์

มีข้อจำกัดกรณีฉายรังสีด้วยอัตราปริมาณรังสีต่อหน่วยเวลา (dose rate) สูง โดยเฉพาะการฉายรังสีเทคนิคการฉายรังสีแบบไม่มีตัวกรองปรับเรียบ (flattening filter free; FFF) เช่น เทคนิคการฉายรังสีแบบปรับความเข้ม (intensity modulated radiation therapy; IMRT) การฉายรังสีแบบปรับความเข้มเชิงปริมาตร (volumetric modulated radiation therapy; VMAT) การฉายรังสีแบบศัลยกรรม (stereotactic radio-surgery; SRS) และการฉายรังสีร่วมพิภักต์บริเวณลำตัว (stereotactic body radiotherapy; SBRT) เนื่องจากอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ใช้วิธีการนับวัดสัญญาณแบบจำนวนเฟรมต่อเวลาทำให้ไม่สามารถนับวัดปริมาณรังสีที่มีอัตราปริมาณรังสีสูงได้จึงเกิดการอ้อมตัวต่อการนับวัดรังสี

จากงานวิจัยที่ผ่านมาได้มีผู้ศึกษาการตอบสนองของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ต่อการฉายรังสีที่ไม่มีตัวกรองปรับเรียบ โดยทดสอบวัดค่าปริมาณรังสีจากการฉายรังสีแบบไม่มีตัวกรองปรับเรียบพลังงาน 6 และ 10 เมกะโวลต์ พบว่าระยะระหว่างอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์และต้นกำเนิดรังสี (source to detector distance; SDD) ตั้งแต่ 130 เซนติเมตร และระยะตั้งแต่ 140 เซนติเมตร ที่พลังงาน 6 และ 10 เมกะโวลต์ ตามลำดับ เป็นระยะที่ไม่ทำให้เกิดการอ้อมตัวของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ งานวิจัยดังกล่าวจึงใช้ระยะ 150 เซนติเมตร เป็นระยะสำหรับวัดค่าปริมาณรังสีจากการฉายรังสีแบบไม่มีตัวกรองปรับเรียบทั้งสองระดับพลังงาน³ นอกจากนี้มีการศึกษาวิจัยคุณลักษณะของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเพิ่มระยะระหว่างอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์และต้นกำเนิดรังสี จากการคำนวณปริมาณรังสีด้วยวิธีแบล็กโปรเจคชัน (back projection algorithm) เมื่อฉายรังสีพลังงาน 6 เมกะโวลต์ โดยกำหนดระยะระหว่างอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์และต้นกำเนิดรังสีเท่ากับ 150 เซนติเมตร เพื่อหาอัตราการให้ปริมาณรังสีต่อเวลาที่เหมาะสมที่ไม่ทำให้เกิดการอ้อมตัวของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าอัตราการให้ปริมาณรังสีต่อเวลา 800 มอนิเตอร์ยูนิตต่อนาที เป็นอัตราสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการอ้อมตัวของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาหาคุณลักษณะของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ในการวัดรังสีแบบไม่มีตัวกรองปรับเรียบด้วยการทดสอบคุณลักษณะของ

การตอบสนองของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ต่อการวัดรังสีเพื่อให้สามารถนำอุปกรณ์ดังกล่าวมาใช้งานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกระบวนการวัดรังสีในการทำประกันคุณภาพก่อนการรักษา

วัสดุและวิธีการ

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้เครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กทรอนิกส์ทรอนรุ่นทรูบีม (TrueBeam) ยี่ห้อวาเรียน (Varian) พลังงาน 6 และ 10 เมกะโวลต์ สำหรับการฉายรังสีแบบไม่มีตัวกรองปรับเรียบพร้อมกับอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์รุ่นอะเมอร์ฟัสซิลิคอน 1000 (aSi-1000) โดยทำการวางแผนการรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษาอีคลิป์ เวอร์ชัน 13.6

1. การสอบเทียบอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EPID calibration)

การสอบเทียบในขั้นตอนนี้เป็นการสอบเทียบอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการวัดปริมาณรังสีตามคู่มือของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์แนะนำ⁷ สำหรับรังสีแบบไม่มีตัวกรองปรับเรียบโดยการสอบเทียบที่ระยะ 150 และ 180 เซนติเมตร สำหรับพลังงาน 6 และ 10 เมกะโวลต์ ตามลำดับ

1.1 การสอบเทียบสัญญาณกรณีไม่ฉายรังสี (dark field calibration)

สอบเทียบสัญญาณของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการแก้ค่าสัญญาณรบกวนจากส่วนประกอบของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์เมื่อไม่มีการฉายรังสี ซึ่งค่าดังกล่าว ($DF(i,j)$) จะถูกนำไปใช้สำหรับลบออกจากสัญญาณที่วัดได้ต่อไป ดังแสดงในสมการที่ 1

1.2 การสอบเทียบความสม่ำเสมอ (flood field calibration)

แก้ค่าการตอบสนองของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละพิกเซลที่มีความไวแตกต่างกันโดยทำการแก้ค่าจากการฉายรังสีแบบไม่มีตัวกรองปรับเรียบพลังงาน 6 และ 10 เมกะโวลต์ ด้วยอัตราปริมาณรังสีต่อหน่วยเวลาต่อเวลาเท่ากับ 400 มอนิเตอร์ยูนิตต่อนาที โดยการฉายรังสีพลังงาน 6 เมกะโวลต์ ทำการสอบเทียบที่ระยะจากแหล่งกำเนิดรังสีถึงอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 150 เซนติเมตร ขนาดพื้นที่ลำรังสี 28×21 ตารางเซนติเมตร และที่ระดับพลังงาน

10 เมกะโวลต์ ทำการสอบเทียบที่ระยะจากแหล่งกำเนิดรังสีถึงอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 180 เซนติเมตร ขนาดพื้นที่ลำรังสี 24×18 ตารางเซนติเมตร โดยค่าการสอบเทียบความสม่ำเสมอของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์แต่ละพิกเซลสามารถคำนวณได้ดังสมการที่ 1

$$I(i, j) = \left(\frac{I_{raw}(i, j) - DF(i, j)}{FF(i, j)} \right) FF_{mean} \quad (1)$$

โดยที่ $I(i, j)$ คือ ภาพจากการสอบเทียบหลังการสอบเทียบ

$I_{raw}(i, j)$ คือ ภาพที่ได้จากการฉายรังสีพื้นที่ขนาดต่างๆ

$DF(i, j)$ คือ ภาพจากการสอบเทียบโดยไม่มีรังสี

$FF(i, j)$ คือ ภาพที่ได้จากการสอบเทียบความสม่ำเสมอ

FF_{mean} คือ ค่าเฉลี่ยของภาพที่ได้จากการสอบเทียบความสม่ำเสมอ

1.3 การสอบเทียบปริมาณรังสี (dose calibration)

การสอบเทียบปริมาณรังสีของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ใช้วิธีการปรับเทียบค่าหน่วยวัดของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ (dose normalization) ระหว่างค่าหน่วยวัดปริมาณรังสีของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยแคลลิเบชันยูนิท (calibration unit; CU) ต่อค่ามอเนอริยูนิต (monitor unit; MU) ที่ได้จากการฉายด้วยเครื่องเร่งอนุภาคโดยทำการฉายรังสีด้วยพื้นที่ลำรังสีขนาด 10×10 ตารางเซนติเมตร จากนั้นทำการสอบเทียบปริมาณรังสีที่ใช้ในทางคลินิก 100 มอเนอริยูนิตให้เป็น 100 แคลลิเบชันยูนิท โดยที่พลังงาน 6 เมกะโวลต์ของการฉายรังสีแบบไม่มีตัวกรองปรับเรียบ ทำการสอบเทียบที่ระยะจากแหล่งกำเนิดรังสีถึงอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 150 เซนติเมตร และที่พลังงาน 10 เมกะโวลต์ของการฉายรังสีแบบไม่มีตัวกรองปรับเรียบ ทำการสอบเทียบที่ระยะจากแหล่งกำเนิดรังสีถึงอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 180 เซนติเมตร จากนั้นทำการแก้ค่าโปรไฟล์ลำรังสี (beam profile correction) เพื่อแก้ค่าความคลาดเคลื่อนของความเข้ม

โฟตอนในตำแหน่งที่ห่างจากกึ่งกลางลำรังสีจากโปรไฟล์ของลำรังสีที่ได้จากการวัดปริมาณรังสีในน้ำที่ระยะความลึกที่ได้รับปริมาณรังสีสูงสุด (depth of dose maximum)

2. การประเมินคุณลักษณะของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์

การประเมินคุณลักษณะของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ทำที่ระยะที่ทำการสอบเทียบอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ตามคำแนะนำของผู้ผลิตตามขั้นตอนที่ 1

2.1 การทดสอบการตอบสนองต่อรังสีในหน่วยมอเนอริยูนิตที่ระยะทางต่างๆ

ทดสอบการตอบสนองต่อรังสีจากค่าปริมาณรังสี 500 มอเนอริยูนิตลำรังสีขนาด 10×10 ตารางเซนติเมตร โดยใช้อัตราปริมาณรังสีต่อหน่วยเวลาต่อเวลาสูงสุดเท่ากับ 1,400 มอเนอริยูนิตต่อนาทีสำหรับพลังงาน 6 เมกะโวลต์ และ 2,400 มอเนอริยูนิตต่อนาที สำหรับพลังงาน 10 เมกะโวลต์ ทำการเปลี่ยนแปลงระยะทางจากต้นกำเนิดรังสีถึงอุปกรณ์รับภาพตั้งแต่ 120–180 เซนติเมตร จากนั้นวิเคราะห์ผลการตอบสนองอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ต่อปริมาณรังสีในหน่วยมอเนอริยูนิตเพื่อทดสอบการตอบสนองตามกฎการแปรผกผันกำลังสองของระยะทาง (inverse square law; ISL)

2.2 การทดสอบระยะทางจากต้นกำเนิดรังสีถึงอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมโดยทำให้การนับวัดรังสีไม่เกิดการอ้อมตัว

วัตถุประสงค์ของการทดสอบนี้ เพื่อตรวจสอบว่าระยะทางจากต้นกำเนิดรังสีถึงอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำสำหรับการวัดรังสีแบบไม่มีตัวกรองปรับเรียบ (ระยะ 150 เซนติเมตรสำหรับพลังงาน 6 เมกะโวลต์ และ 180 เซนติเมตรสำหรับพลังงาน 10 เมกะโวลต์) เป็นระยะที่เหมาะสมที่ทำให้การนับวัดรังสีไม่อ้อมตัว ทดสอบโดยวัดค่าปริมาณรังสีด้วยอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเปลี่ยนแปลงค่าปริมาณรังสีต่อเวลาขนาดต่างๆ กำหนดค่าการฉายรังสี 500 มอเนอริยูนิต ขนาดลำรังสี 10×10 ตารางเซนติเมตร ทำการเปลี่ยนแปลงค่าปริมาณรังสีต่อเวลาตั้งแต่ค่าปกติถึงค่าปริมาณรังสีต่อเวลาสูงสุด ประกอบด้วย ค่าปริมาณรังสี 400–1,400 มอเนอริยูนิตต่อนาทีสำหรับพลังงาน 6 เมกะโวลต์

และค่าปริมาณรังสีต่อเวลา 400–2,400 มอนิเตอร์ยูนิตต่อนาที่สำหรับพลังงาน 10 เมกะโวลต์ จากนั้นเปลี่ยนแปลงระยะทางจากต้นกำเนิดรังสีถึงอุปกรณ์รับภาพตั้งแต่ 120–180 เซนติเมตร วิเคราะห์ผลโดยการประเมินจากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตรารังสีต่อเวลา (มอนิเตอร์ยูนิตต่อนาที่) กับปริมาณรังสีสัมพัทธ์ที่อุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์วัดได้ (นอร์มอลไลซ์กับปริมาณรังสีที่อัตรารังสีต่อเวลา 400 มอนิเตอร์ยูนิตต่อนาที่) นอกจากนี้การทดสอบนี้ยังประเมินจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณรังสีหน่วยแคลลิเบชันยูนิต (calibration unit; CU) ของระยะทางต้นกำเนิดรังสีถึงอุปกรณ์รับภาพใดๆ ที่วัดได้จากอัตราปริมาณรังสีต่อเวลาต่างๆ

2.3 การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นของค่าปริมาณรังสี

วัดค่าการตอบสนองปริมาณรังสีของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์กำหนดระยะจากต้นกำเนิดรังสีถึงอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 150 และ 180 เซนติเมตร สำหรับพลังงาน 6 และ 10 เมกะโวลต์ตามลำดับ (ตามที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำสำหรับการวัดรังสีแบบไม่มีตัวกรองปรับเทียบ) เปิดพื้นที่ลำรังสีเท่ากับ 10×10 ตารางเซนติเมตร อัตราปริมาณรังสีต่อหน่วยเวลาเท่ากับ 1,400 สำหรับพลังงาน 6 เมกะโวลต์และค่าอัตราปริมาณรังสีต่อหน่วยเวลาเท่ากับ 2,400 มอนิเตอร์ยูนิตต่อนาที่สำหรับพลังงาน 10 เมกะโวลต์ โดยเปลี่ยนแปลงค่ามอนิเตอร์ยูนิตตั้งแต่ 10–1,000 มอนิเตอร์ยูนิต จากนั้นประเมินความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (linearity) ด้วยการวิเคราะห์การตอบสนองระหว่างค่าปริมาณรังสีของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยแคลลิเบชันยูนิตและค่าปริมาณรังสีจากเครื่องเร่งอนุภาคในหน่วยมอนิเตอร์ยูนิต

2.4 การทดสอบการตอบสนองของค่าปริมาณรังสีต่อพื้นที่ลำรังสี

ทำการทดสอบการตอบสนองค่าปริมาณรังสีที่วัดได้จากอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์เมื่อฉายรังสีที่ลำรังสีขนาด 3×3, 4×4, 5×5, 8×8, 10×10, 12×12, 15×15 และ 18×18 ตารางเซนติเมตร กำหนดระยะจากต้นกำเนิดรังสีถึงอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 150 เซนติเมตรสำหรับพลังงาน 6 เมกะโวลต์ และ 180 เซนติเมตรสำหรับพลังงาน 10 เมกะโวลต์ แบบไม่มีตัวกรองปรับเทียบ ด้วยค่าปริมาณรังสี

500 มอนิเตอร์ยูนิต ปริมาณรังสีต่อหน่วยเวลาเท่ากับ 1,400 สำหรับพลังงาน 6 เมกะโวลต์ และปริมาณรังสีต่อหน่วยเวลาเท่ากับ 2,400 มอนิเตอร์ยูนิตต่อนาที่สำหรับพลังงาน 10 เมกะโวลต์ จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของพื้นที่ลำรังสีกับค่าปริมาณรังสีสัมพัทธ์ (relative dose) ที่ได้จากการนำค่าปริมาณรังสีที่วัดได้ที่ลำรังสีขนาดต่างๆ เปรียบเทียบกับลำรังสีขนาด 10×10 ตารางเซนติเมตร การทดสอบนี้ยังได้เปรียบเทียบกับ การตอบสนองต่อพื้นที่ลำรังสีของรังสีแบบมีตัวกรองปรับเทียบด้วย

ผลการศึกษา

ผลการทดสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ในการวัดค่าปริมาณรังสีแบบไม่มีตัวกรองปรับเทียบของเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กทรอนิกส์ทรอน รุ่นทรูบีม พลังงาน 6 และ 10 เมกะโวลต์ ได้ผลการทดลองดังต่อไปนี้

1. การสอบเทียบอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์

1.1 การสอบเทียบสัญญาณกรณีไม่ฉายรังสี



การสอบเทียบสัญญาณของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการแก้ค่าสัญญาณรบกวนเป็นไปตามคู่มือที่อุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์แนะนำ

1.2 การสอบเทียบความสม่ำเสมอ

การแก้ค่าความสม่ำเสมอในแต่ละพิกเซลของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์จากการฉายรังสีเป็นไปตามคู่มือที่อุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์แนะนำ

1.3 การสอบเทียบปริมาณรังสี

ผลการแก้ค่าโปรไฟล์ลำรังสีของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์จากข้อมูลโปรไฟล์ที่ได้จากการวัดปริมาณรังสีในน้ำที่ระยะความลึกที่ได้รับปริมาณรังสีสูงสุดเพื่อให้เกิดการตอบสนองต่อการวัดรังสีด้วยการฉายแบบไม่มีตัวกรองปรับเทียบที่เหมาะสม พบว่าโปรไฟล์ของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์จากการวัดรังสีในการฉายแบบไม่มีตัวกรองปรับเทียบพื้นที่ลำรังสีขนาด 10×10 ตารางเซนติเมตร ที่พลังงาน 6 และ 10 เมกะโวลต์ มีลักษณะแหลม (forward peak profile) บริเวณกลางลำรังสีมีค่าสูงกว่าด้านข้างซึ่งเป็นลักษณะโปรไฟล์ของการฉายแบบไม่มีตัวกรองปรับเทียบ ดังรูปที่ 1

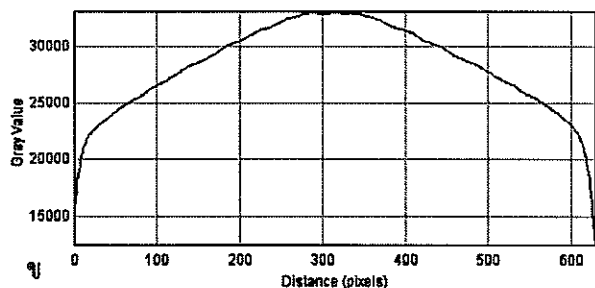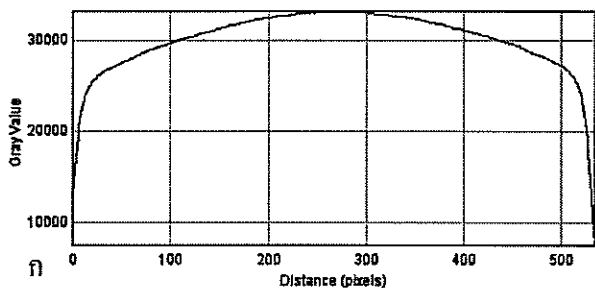

รูปที่ 1 โปรไฟล์ของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากประยุกต์โปรไฟล์ของน้ำในการฉายรังสีแบบไม่มีตัวกรองปรับเรียบที่ระดับความลึกที่ให้ปริมาณรังสีสูงสุดให้กับอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ โดยโปรไฟล์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางในหน่วยพิกเซล (pixels) และค่าระดับความเข้ม (gray value) สำหรับพลังงาน (ก) 6 เมกะโวลต์ และ (ข) 10 เมกะโวลต์

2. การประเมินคุณลักษณะของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์

2.1 การทดสอบการตอบสนองต่อปริมาณรังสีที่ระยะทางต่างๆ

ผลการตอบสนองของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ระยะ 120 เซนติเมตร พลังงาน 6 เมกะโวลต์ มีความสอดคล้องกับตามกฎการแปรผกผันกำลังสองของระยะทาง โดยมีการลดลงของปริมาณรังสีตามระยะทางที่เพิ่มขึ้น สำหรับพลังงาน 10 เมกะโวลต์ พบการอ้อมตัวของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ระยะ 120-130 เซนติเมตร เนื่องจากฉายรังสีด้วยอัตราปริมาณรังสีต่อหน่วยเวลาสูง (2,400 มอนิเตอร์ยูนิตต่ออนาที) ทำให้ในช่วงระยะทางดังกล่าว ค่าปริมาณรังสีไม่เป็นไปตามกฎการแปรผกผันกำลังสองของระยะทาง ดังรูปที่ 2

2.2 การทดสอบระยะทางจากต้นกำเนิดรังสีถึงอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมโดยทำให้การนับวัดรังสีไม่เกิดการอ้อมตัว

ผลการทดสอบการอ้อมตัวเมื่อเปลี่ยนแปลงอัตราปริมาณรังสีต่อหน่วยเวลาตั้งแต่ 400-1,400 มอนิเตอร์ยูนิตต่ออนาที ระยะทางตั้งแต่ 120-180 เซนติเมตร ในการฉายรังสีแบบไม่มีตัวกรองปรับเรียบด้วยพลังงาน 6 เมกะโวลต์ พบว่าที่ระยะ 150 เซนติเมตร มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแคลลิเบชันยูนิตเท่ากับ ± 1.35 สำหรับการทดสอบการอ้อมตัวเมื่อเปลี่ยนแปลงอัตราปริมาณรังสีต่อหน่วยเวลาตั้งแต่ 400-2,400 มอนิเตอร์ยูนิตต่ออนาที และระยะทางตั้งแต่ 120-180 เซนติเมตร ด้วยพลังงาน 10 เมกะโวลต์ พบว่าการวัดค่าปริมาณรังสีที่ระยะ 180 เซนติเมตร มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแคลลิเบชันยูนิตเท่ากับ ± 1.64 และพบว่าสำหรับการวัดรังสีทั้งพลังงาน 6 และ 10 เมกะโวลต์ เมื่อเพิ่มระยะทางมากขึ้นจะทำให้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแคลลิเบชันยูนิตมีค่าลดลง (ตารางที่ 1)

เมื่อวิเคราะห์การตอบสนองของการวัดค่าปริมาณรังสีจากอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์กับการเปลี่ยนแปลงอัตราปริมาณรังสีต่อหน่วยเวลาจากกราฟดังแสดงในรูปที่ 3 พบว่าการวัดปริมาณรังสีในการฉายแบบไม่มีตัวกรองปรับเรียบของพลังงาน 6 เมกะโวลต์ เส้นกราฟเป็นเส้นตรงเรียบสำหรับระยะทาง 120-180 เซนติเมตร และการวัดปริมาณรังสีพลังงาน 10 เมกะโวลต์ พบว่าที่ระยะ 120 และ 130 เซนติเมตร เส้นกราฟเริ่มไม่เป็นเส้นตรงเรียบ โดยเริ่มไม่เรียบที่อัตราปริมาณรังสีต่อเวลา 1,600 มอนิเตอร์ยูนิตต่ออนาที สำหรับระยะทาง 120 เซนติเมตร และ 2,000 มอนิเตอร์ยูนิตต่ออนาที สำหรับระยะทาง 130 เซนติเมตร

2.3 การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นของค่าปริมาณรังสี

ผลการเปลี่ยนแปลงค่ามอนิเตอร์ยูนิตตั้งแต่ 10-1,000 มอนิเตอร์ยูนิตที่อัตราการให้ปริมาณรังสีสูงสุด 1,400 มอนิเตอร์ยูนิตต่ออนาที สำหรับพลังงาน 6 เมกะโวลต์ และ 2,400 มอนิเตอร์ยูนิตต่ออนาที สำหรับพลังงาน 10 เมกะโวลต์ พบว่าการตอบสนองต่อการวัดรังสีของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะเชิงเส้นตรงทั้งสองระดับพลังงานดังรูปที่ 4 โดยความ

สัมพันธ์ระหว่างค่าปริมาณรังสีในหน่วยมอโนเตอร์ยูนิตและค่าปริมาณรังสีในหน่วยแคลลิเบชันยูนิตที่นับวัดได้จากอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์มีค่า R^2 เท่ากับ 1 ทั้งสองระดับพลังงาน


2.4 การทดสอบการตอบสนองของค่าปริมาณรังสีต่อพื้นที่ลำรังสี

การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่ลำรังสีจากการวัดด้วยอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อทำการวัดที่ตำแหน่งกึ่งกลางของพื้นที่ลำรังสี โดยกำหนดขนาดพื้นที่สำหรับวัดค่าปริมาณรังสีเท่ากับ 20x20 พิกเซล จากนั้นทำการเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากพื้นที่ลำรังสีขนาด 10x10 ตารางเซนติเมตร ผลการเปรียบเทียบค่าปริมาณรังสีระหว่างการฉายรังสีแบบมีตัวกรองปรับเรียบ และไม่มีตัวกรองปรับเรียบ พบว่าค่าปริมาณรังสีทั้งสองระดับพลังงานของการฉายรังสีแบบไม่มีตัวกรองปรับเรียบมีค่าสูงกว่าการฉายแบบมีตัวกรองปรับเรียบ เมื่อพื้นที่ลำรังสีขนาดเล็กกว่า 10x10 ตารางเซนติเมตร และเมื่อพื้นที่ลำรังสีมีขนาดมากกว่า 10x10 ตารางเซนติเมตร พบว่าค่าปริมาณรังสีของการฉายรังสีแบบมีตัวกรองปรับเรียบมีค่าสูงกว่าการฉายรังสีแบบไม่มีตัวกรองปรับเรียบ แสดงดังรูปที่ 5 โดยมีความแตกต่างสูงสุดของการตอบสนองรังสีต่อพื้นที่

ลำรังสีระหว่างแบบมีตัวกรองปรับเรียบ และไม่มีตัวกรองปรับเรียบ คือ ร้อยละ 5.50 และ 6.78 ที่ระดับพลังงาน 6 และ 10 เมกะโวลต์ ตามลำดับ

วิจารณ์

การทดสอบการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงระยะทางของการฉายรังสีด้วยพลังงาน 10 เมกะโวลต์ ดังแสดงในรูปที่ 2 พบว่าค่าปริมาณรังสีที่นับวัดได้ไม่เป็นไปตามกฎการแปรผกผันกำลังสองของระยะทางที่ระยะ 120-130 เซนติเมตร เนื่องจากอัตราปริมาณรังสีต่อหน่วยเวลา 2,400 มอโนเตอร์ยูนิตต่อนาทีเป็นอัตราการให้รังสีสูงมาก ทำให้หัววัดรังสีของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์เกิดการอิ่มตัวสอดคล้องกับงานของ Pardo และคณะ⁵ ซึ่งพบว่าระยะต้นกำเนิดรังสีถึงอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่น้อยกว่า 140 เซนติเมตร เป็นระยะที่ทำให้อุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์เกิดการอิ่มตัวที่พลังงาน 10 เมกะโวลต์ เมื่อเพิ่มระยะทางจากต้นกำเนิดรังสีถึงอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ 140-160 เซนติเมตร ส่งผลให้อุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์สามารถนับวัดค่าปริมาณรังสีได้โดยไม่เกิดการอิ่มตัว

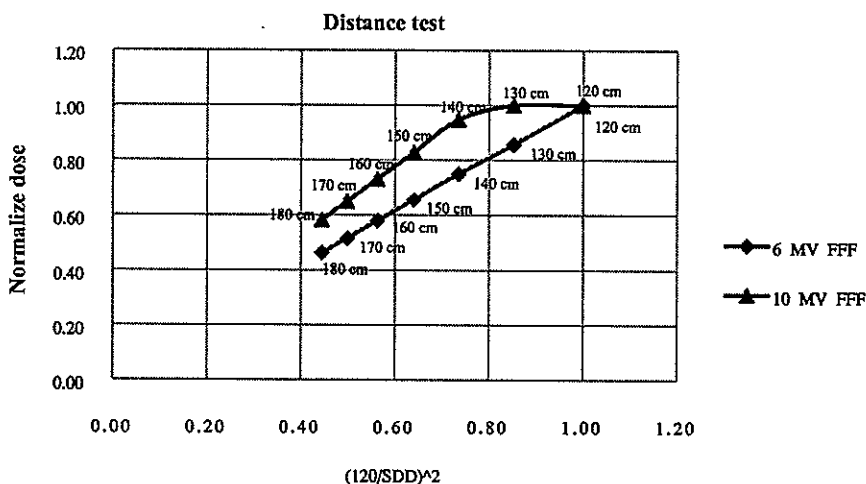



รูปที่ 2 กราฟการตอบสนองตามกฎการแปรผกผันกำลังสองของระยะทางระหว่างระยะทางและค่าปริมาณรังสีในหน่วยแคลลิเบชันยูนิต โดยแกน x แสดงค่าระยะทางที่ทำกรวัดค่าเปรียบเทียบกับระยะ 120 เซนติเมตร ทั้งหมดยกกำลังสอง (ISL) และแกน y แสดงค่าปริมาณรังสีที่ระยะต่างๆ เปรียบเทียบกับระยะ 120 เซนติเมตร

ตารางที่ 1 แสดงค่าปริมาณรังสีที่วัดได้ในหน่วยแคลลิเบชันยูนิิต เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ปริมาณรังสีต่อเวลา และระยะระหว่างต้นกำเนิดรังสีถึงอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ ที่ระดับพลังงาน 6 และ 10 เมกะโวลต์ โดยใช้ปริมาณรังสีเท่ากับ 500 มอนิเตอร์ยูนิิต


SDD (cm)	6 MV FFF, 500 MU								
	Dose rate (MU/min)							AVG.	S.D.
	1400	1200	1000	800	600	400			
120	765.26	765.51	768.61	770.10	772.14	773.76	769.23	3.45	
130	655.66	656.27	657.59	659.10	660.32	661.09	658.34	2.19	
140	567.53	568.59	569.72	570.86	571.63	572.38	570.12	1.85	
150	497.18	498.20	499.05	499.62	500.32	500.81	499.20	1.35	
160	439.42	440.20	440.75	441.19	441.81	442.16	440.92	1.02	
170	391.38	391.92	392.30	392.81	393.18	393.53	392.52	0.81	
180	351.14	351.52	351.89	352.17	352.56	352.85	352.02	0.64	

SDD (cm)	10 MV FFF, 500 MU								
	Dose rate (MU/min)							AVG.	S.D.
	2400	2000	1600	1200	800	400			
120	852.82	1021.20	1089.86	1093.00	1097.51	1100.74	1042.52	97.61	
130	851.89	931.85	933.28	936.79	939.45	941.97	922.54	34.81	
140	805.88	806.35	808.25	810.97	813.09	814.77	809.88	3.65	
150	704.32	705.66	707.60	709.46	711.09	712.17	708.38	3.08	
160	621.33	623.13	624.79	626.16	627.45	628.34	625.20	2.66	
170	553.13	554.70	555.49	556.91	557.94	558.79	556.16	2.12	
180	496.13	497.36	497.93	499.03	499.96	500.46	498.48	1.64	



MV=megavoltage, FFF=flattening filter-free, MU=monitor unit, SDD=source-detector-distance, AVG=average S.D.=standard deviation

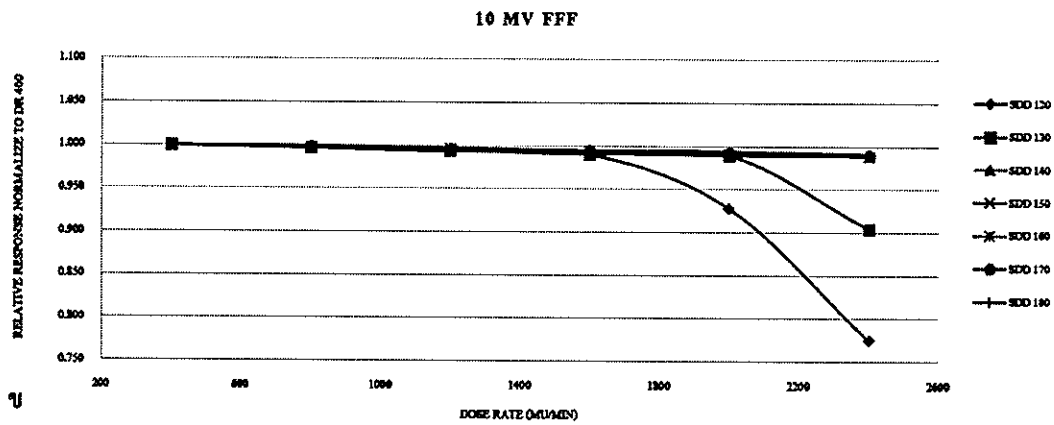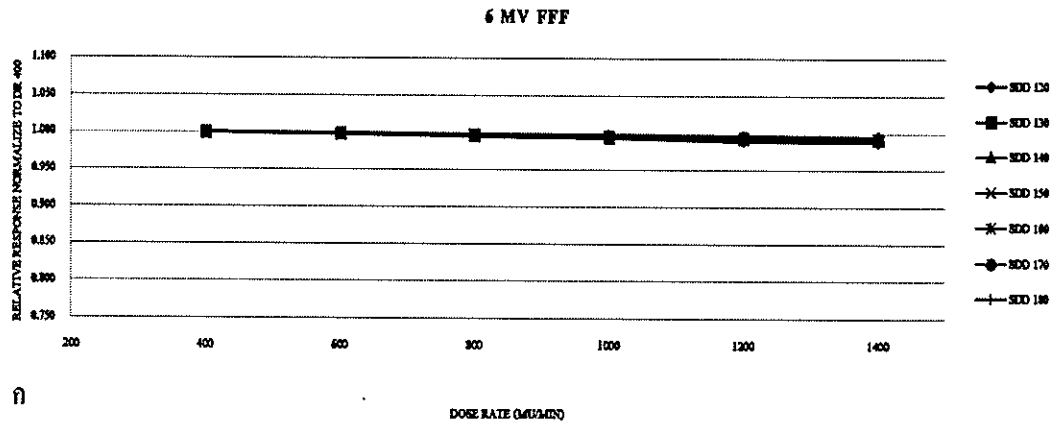

รูปที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราปริมาณรังสีต่อหน่วยเวลาและค่าปริมาณรังสีในหน่วยแคลลิเบชันยูนิทของพลังงาน (ก) 6 และ (ข) 10 เมกะโวลต์ที่ระยะต่างๆ

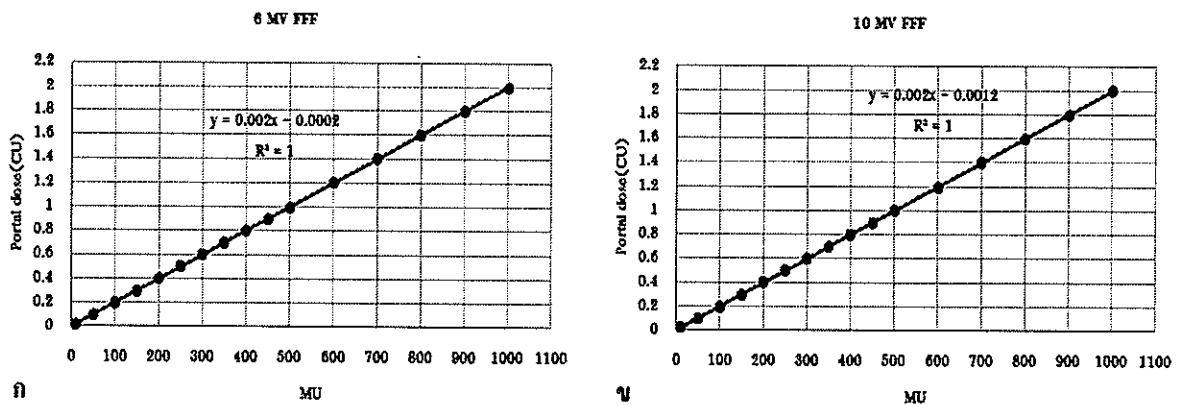

รูปที่ 4 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าปริมาณรังสีในหน่วยมอนิเตอร์ยูนิทและค่าปริมาณรังสีในหน่วยแคลลิเบชันยูนิทที่นับวัดได้จากอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ของพลังงาน (ก) 6 และ (ข) 10 เมกะโวลต์

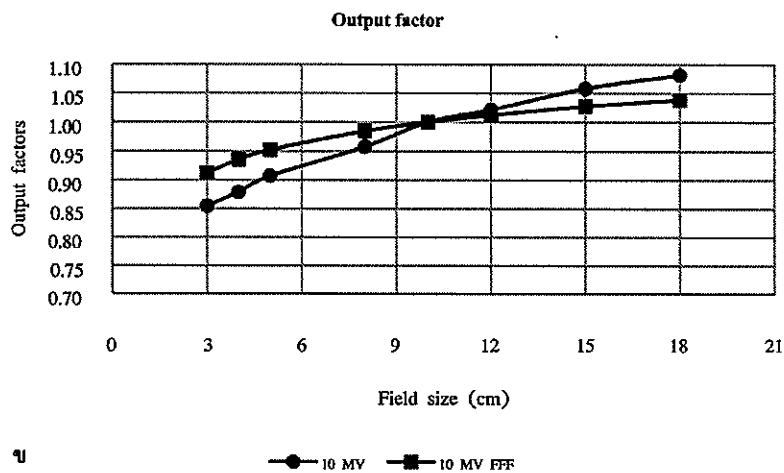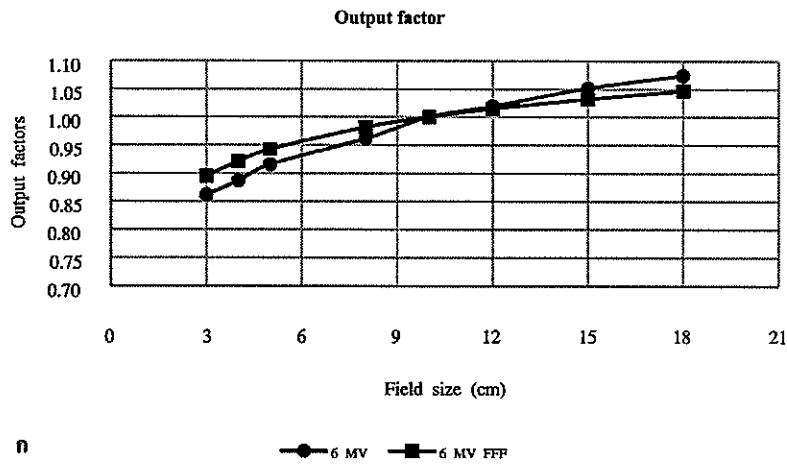

รูปที่ 5 กราฟการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่ลำรังสีระหว่างการฉายรังสีแบบมีตัวกรองปรับเรียบและไม่มีตัวกรองปรับเรียบ ที่พลังงาน (ก) 6 และ (ข) 10 เมกะโวลต์ ในพื้นที่ลำรังสีขนาด 3x3 ถึง 18x18 ตารางเซนติเมตร

การทดสอบการตอบสนองต่ออัตราปริมาณรังสีต่อหน่วยเวลาและระยะทางพบวาระยะ 150 และ 180 เซนติเมตรตามที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำ มีความเหมาะสมสำหรับวัดปริมาณรังสีด้วยการฉายแบบไม่มีตัวกรองปรับเรียบของพลังงาน 6 และ 10 เมกะโวลต์ตามลำดับ โดยที่ระยะดังกล่าวสามารถนำไปใช้กับทุกค่าอัตราปริมาณรังสีต่อหน่วยเวลาของการฉายแบบไม่มีตัวกรองปรับเรียบได้

การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างค่าปริมาณรังสีที่อุปกรณ์รับภาพวัดได้และมอโนเตอร์ยูนิท พบว่ามีความสัมพันธ์

เชิงเส้นตรงในช่วง 10-1,000 มอโนเตอร์ยูนิททั้งสองระดับพลังงาน ซึ่งช่วงมอโนเตอร์ยูนิทดังกล่าวเป็นช่วงที่ใช้ในการฉายรังสีแบบคัลยกรรมและการฉายรังสีร่วมฟิสิกส์บริเวณลำตัว จากผลการทดสอบนี้แสดงให้เห็นว่าสามารถนำอุปกรณ์รับภาพไปสอบเทียบเพื่อใช้ในการวัดรังสีแบบคัลยกรรมและการฉายรังสีร่วมฟิสิกส์บริเวณลำตัวได้ และการทดสอบการตอบสนองของรังสีกับขนาดพื้นที่ลำรังสีพบว่าค่าปริมาณรังสีทั้งสองระดับพลังงานของการฉายรังสีแบบไม่มีตัวกรองปรับเรียบมีค่าสูงกว่าการฉายแบบมีตัวกรองปรับเรียบสำหรับพื้นที่ลำรังสีขนาด

เล็กกว่า 10×10 ตารางเซนติเมตร และเมื่อพื้นที่ลำรังสีมีขนาดมากกว่า 10×10 ตารางเซนติเมตร พบว่าการฉายรังสีแบบมีตัวกรองปรับเรียบมีค่าปริมาณรังสีสูงกว่าการฉายรังสีแบบไม่มีตัวกรองปรับเรียบ โดยพลังงานที่สูงขึ้นและขนาดพื้นที่ลำรังสีที่มากขึ้นมีผลทำให้ค่าปริมาณรังสีระหว่างการฉายรังสีทั้ง 2 แบบต่างกันมากขึ้น ความแตกต่างนี้มีผลจากการเกิดรังสีกระเจิง (scatter radiation) ภายในหัวของเครื่องเร่งอนุภาค โดยมีผลจากการใช้ตัวกรองปรับเรียบ ซึ่งจากการที่ตัวกรองปรับเรียบมีความหนาไม่เท่ากัน เมื่อเปิดรังสีที่มีขนาดแตกต่างกัน พลังงานเฉลี่ยของรังสีที่ผ่านตัวกรองปรับเรียบจึงมีผลจากขนาดของลำรังสีมาก ขณะที่การฉายรังสีแบบไม่มีตัวกรองปรับเรียบมีพลังงานเฉลี่ยใกล้เคียงกันที่ขนาดลำรังสีต่างๆ ทำให้การเกิดรังสีกระเจิงภายในหัวของเครื่องเร่งอนุภาคลดลงสอดคล้องกับงานของ Shende และคณะ⁶ ซึ่งมีค่าปริมาณรังสีทั้งสองระดับพลังงานของการฉายรังสีแบบไม่มีตัวกรองปรับเรียบสูงกว่าการฉายแบบมีตัวกรองปรับเรียบสำหรับพื้นที่ลำรังสีขนาดเล็กกว่า 10×10 ตารางเซนติเมตร และเมื่อพื้นที่ลำรังสีมีขนาดมากกว่า 10×10 ตารางเซนติเมตร พบว่าค่าปริมาณรังสีของการฉายรังสีแบบมีตัวกรองปรับเรียบมีค่าสูงกว่าการฉายรังสีแบบไม่มีตัวกรองปรับเรียบ เนื่องจากปริมาณรังสีขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ลำรังสีน้อยกว่าแบบมีตัวกรองปรับเรียบ โดยการฉายรังสีแบบไม่มีตัวกรองปรับเรียบทำให้เกิดการกระเจิงของรังสีลดลงจากการทดลองในงานวิจัยนี้ได้ทำการตรวจสอบระยะทางที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำสำหรับวัดรังสีแบบไม่มีตัวกรองปรับเรียบที่เหมาะสม ซึ่งพบว่าระยะทางที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำสามารถทำให้อุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์สามารถวัดการฉายรังสีแบบไม่มีตัวกรองปรับเรียบได้ในทุกๆ ค่าของอัตราปริมาณรังสีต่อหน่วยเวลา และสามารถใช้ระยะดังกล่าวเพื่อทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างค่าปริมาณรังสีที่อุปกรณ์รับภาพวัดได้ต่อค่ามอนิเตอร์ยูนิทและขนาดพื้นที่ลำรังสีได้

สรุป

จากการทดสอบคุณสมบัติต่อการวัดรังสีแบบไม่มีตัวกรองปรับเรียบของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ในด้านต่างๆ พบว่าสามารถนำมาใช้ในการวัดปริมาณ

รังสีแบบไม่มีตัวกรองปรับเรียบได้ โดยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นที่ตรงระหว่างค่าปริมาณรังสีที่อุปกรณ์รับภาพวัดได้และมอนิเตอร์ยูนิท นอกจากนี้ยังพบว่าอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์รุ่นอะมอร์ฟัสซิลิคอน 1,000 สามารถวัดปริมาณรังสีได้ทุกค่าของอัตราการให้รังสีต่อหน่วยเวลา โดยการขยายระยะแหล่งกำเนิดรังสีถึงอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ตามที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำเป็น 150 และ 180 เซนติเมตร สำหรับพลังงาน 6 และ 10 เมกะโวลต์ตามลำดับ ซึ่งจะช่วยลดการอ้อมตัวของกาารวัดค่าปริมาณรังสีได้

เอกสารอ้างอิง

1. Camilleri J, Mazurier J, Franck D, Dudouet P, Latorzeff I, Franceries X. 2D EPID dose calibration for pretreatment quality control of conformal and IMRT fields: a simple and fast convolution approach. *Physica Medica* 2016; 32: 133 – 40.
2. Mekuria Y, Bjorkqvist M, Kulmala J. Quality control and pre-treatment quality assurance application of EPID (as1000) for FF and FFF beam VMAT plans. *MPI Journal* 2015; 3: 120 – 5.
3. Nicolini G, Clivio A, Vanetti E, Krauss H, Fenoglietto P, Cozzi L, et al. Evaluation of an aSi-EPID with flattening filter free beams: applicability to the GLAA algorithm for portal dosimetry and first experience for pretreatment QA of RapidArc. *Med Phys* 2013; 40: 1 – 8
4. Chuter RW, Rixham PA, Weston SJ, Cosgrove VP. Feasibility of portal dosimetry for flattening filter-free radiotherapy. *J Appl Clin Med Phys* 2016; 17: 112 – 20.
5. Pardo E, Castro NJ, Molina MY, Ruiz MS. On flattening filter-free portal dosimetry. *Med Phys* 2016; 17: 132 – 45.
6. Shende R, Gupta G, Patel G, Kumar S. Commissioning of TrueBeam Medical Linear Accelerator: quantitative and qualitative dosimetric analysis and comparison of flattening filter (FF) and flattening filter free (FFF) Beam. *International Journal of Medical Physics* 2016; 5: 51 – 9.
7. Varian Medical Systems. Vision documentation: portal vision & dosimetry 6.5. Palo Alto: Varian Medical Systems; 2003.

